




# КАТАЛОГ | 2025

проктология

## АО «ОПТИМЕД»

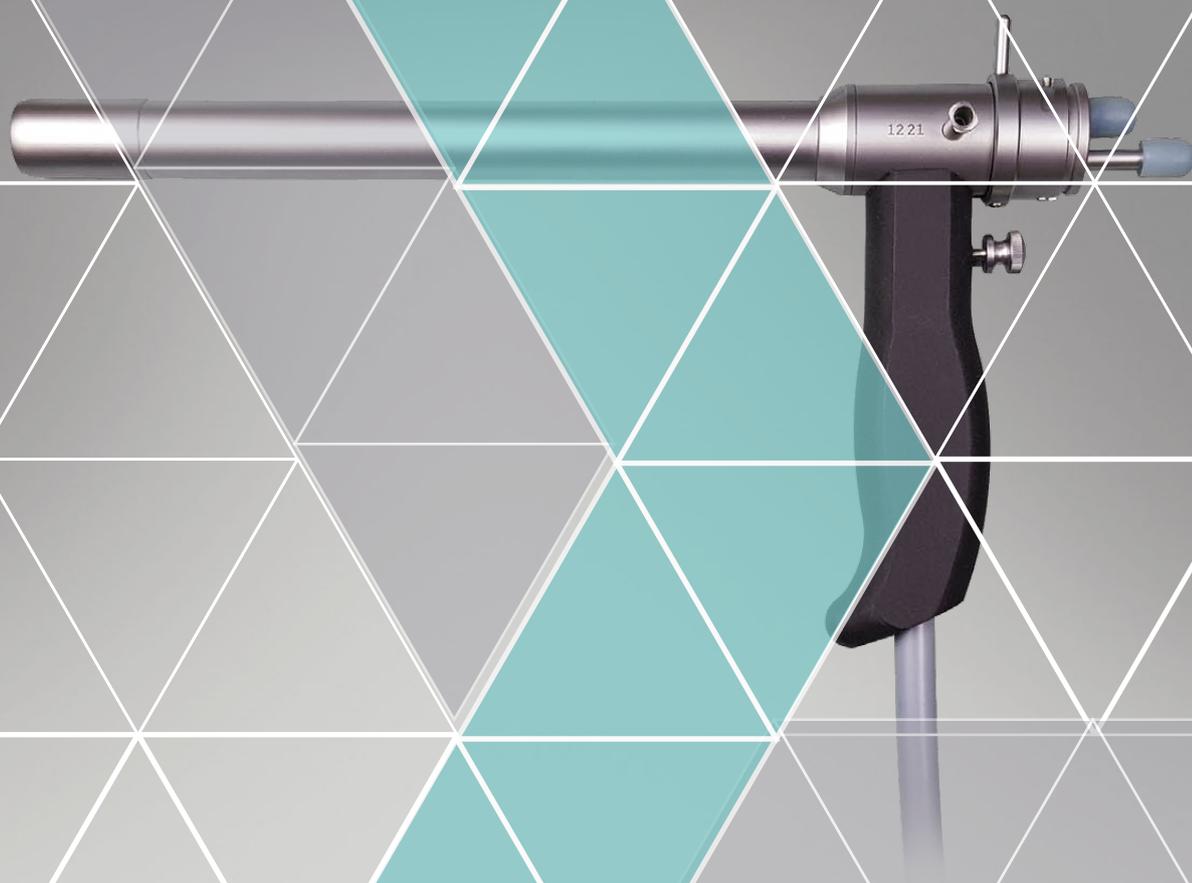



## Ректоскопы с волоконными световодами

**Ректоскопы «ОПТИМЕД»** предназначены для проведения ректоскопии (ректороманоскопии), одной из наиболее распространенных методик эндоскопического обследования прямой и нижнего отдела сигмовидной кишки, имеющая большую эффективность.

Ректоскопия обеспечивает точную диагностику при подозрении на колит, болезнь Крона, инфильтративные процессы, проктит, геморрой, новообразования толстой кишки.

### Показания к ректороманоскопии (ректоскопии)

- хронические запоры или чередование их с жидким стулом;
- боль в нижнем левом отделе живота, промежности, области ануса;
- выпадение прямой кишки во время дефекации;
- зуд в области заднего прохода;
- патологические изменения в кале: кровь, гной, слизь.



Ректоскопы с волоконными световодами «ОПТИМЕД» отличаются высокой надежностью, большим выбором типоразмеров тубусов и эндоскопического инструмента, гибкостью конфигурирования комплектов.

Ректоскопы применяются совместно с эндоскопическими осветителями «ОПТИМЕД» и кабелями для передачи света.

Монополярный инструмент используется совместно с электрохирургическими аппаратами.



## Ректоскопы с волоконными световодами Pe-BC-3, Pe-BC-5

Ректоскопы «ОПТИМЕД» изготовленные из медицинской нержавеющей стали с волоконными осветительными системами, позволяют визуально оценить внутреннюю поверхность прямой и дистальной трети сигмовидной кишки, провести точную диагностику, взятие биопсии; удаление полипов, инородных тел; коагуляцию тканей.



### Особенности

- встроенная волоконная осветительная система;
- широкий выбор операционных, смотровых и детских комплектов ректоскопов;
- нержавеющая сталь, высокая коррозионная стойкость;
- использование жесткого эндоскопического инструмента.



### Характеристики:

Диаметр тубусов	10, 15, 20 мм
Длина тубусов	150, 200, 250, 300 мм

Ректоскопы «ОПТИМЕД» модульная система состоящая из тубусов ректоскопов, эндоскопического инструмента и принадлежностей для их применения, системы визуализации и принадлежностей для проведения ректороманоскопии и очистки ректоскопов.

Ректоскопы используются совместно с эндоскопическими осветительными системами.



## Тубус ректоскопа (в комплекте с obturatorом)

- атравматичный оливообразный дистальный конец obturatorа;
- нержавеющая сталь, матовая поверхность;
- встроенная осветительная система с волоконным световодом;
- разъем типа «луер» для подключения нагнетателя.



<b>5.970.653</b>	D=10 мм	L=150 мм
<b>5.970.655</b>	D=15 мм	L=200 мм
<b>5.970.657</b>	D=20 мм	L=250 мм
<b>5.970.659</b>	D=20 мм	L=200 мм
<b>5.970.696</b>	D=20 мм	L=300 мм
<b>5.970.698</b> (проктоскоп)	D=20 мм	L=150 мм

## Лупа

- увеличение не менее 2<sup>x</sup>;
- диапазон настроек для коррекции аметропии ±5 дптр.;
- фиксация лупы к крышке защитной типа "ласточкин хвост".



**9.950.642**

## Ручка

- электроизолированная ручка;
- удобство работы с тубусами и смотровым anoskopом.



**6.355.537**



## Крышка защитная

- герметизация тубуса в процессе исследования;
- матовая поверхность;
- разъем для подсоединения лупы.



---

5.927.580

---

## Насадка

- герметизация тубуса при вводе инструментов;
- канал для введения инструмента D=5 мм;
- матовая поверхность.



---

5.927.582

---



## Щипцы ректоскопические

- щипцы используют для сжимания, захватывания, откусывания или удерживания каких либо предметов или тканей, а также для забора образцов ткани для биопсии;
- возможность монополярной коагуляции тканей;
- D=5 мм.



---

### Щипцы биопсийные монополярные

- для забора образцов ткани для биопсии



---

### Щипцы захватывающие монополярные

- для захватывания и удерживания каких-либо предметов или тканей





## Нагнетатель

- нагнетания воздуха при введении тубусов в прямую кишку для расправления складок органа.

---

5.887.639

---




## Ватодержатель

- удаления слизи и секрета при ректоскопии;
- трехзубый и Г-образным захватом.

---

5.508.516

---

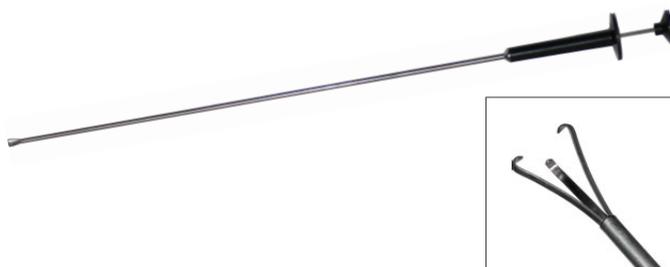

## Щетка

- для взятия соскоба в процессе исследования.

---

6.366.668

---



## Колпачки силиконовые

- уплотнительные колпачки для инструментальных каналов;
- с отверстием - опционально.

---

8.656.000-01 с отверстием


---

8.656.000-01 без отверстия

---



# Совместимость элементов ректоскопов Основные элементы

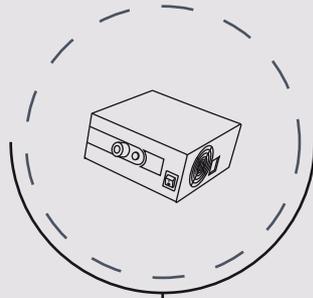


осветители  
эндоскопические  
ОсГ-01,  
ОсС-01




используется со всеми типами  
и размерами тубусов  
ректоскопа

ручка


нагнетатель




лупа



кабель передачи  
света  
D=5 мм L=1800 мм




крышка  
защитная

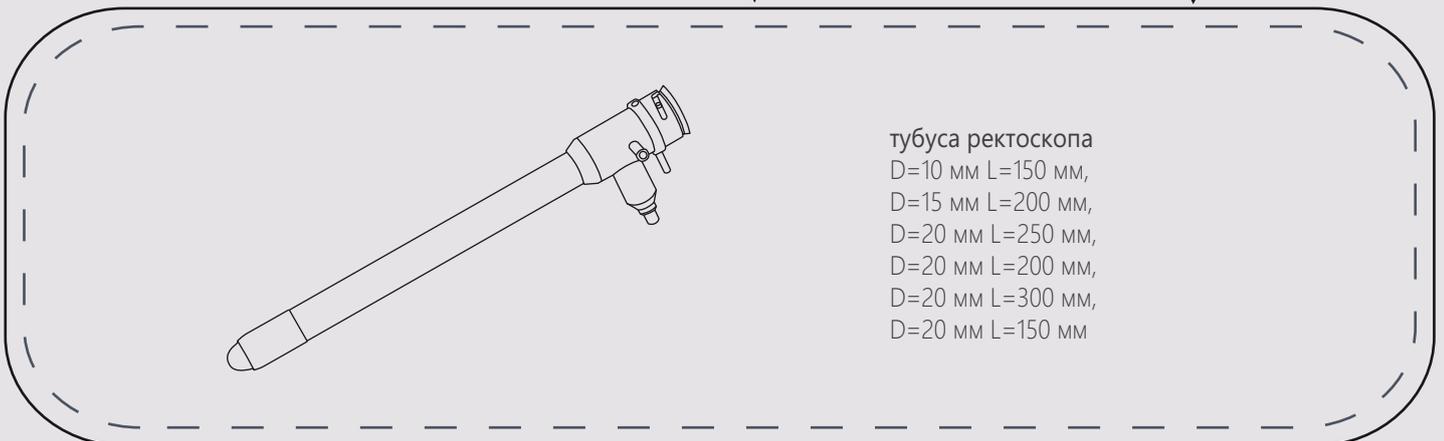

тубуса ректоскопа  
D=10 мм L=150 мм,  
D=15 мм L=200 мм,  
D=20 мм L=250 мм,  
D=20 мм L=200 мм,  
D=20 мм L=300 мм,  
D=20 мм L=150 мм

# Совместимость элементов ректоскопов Инструменты

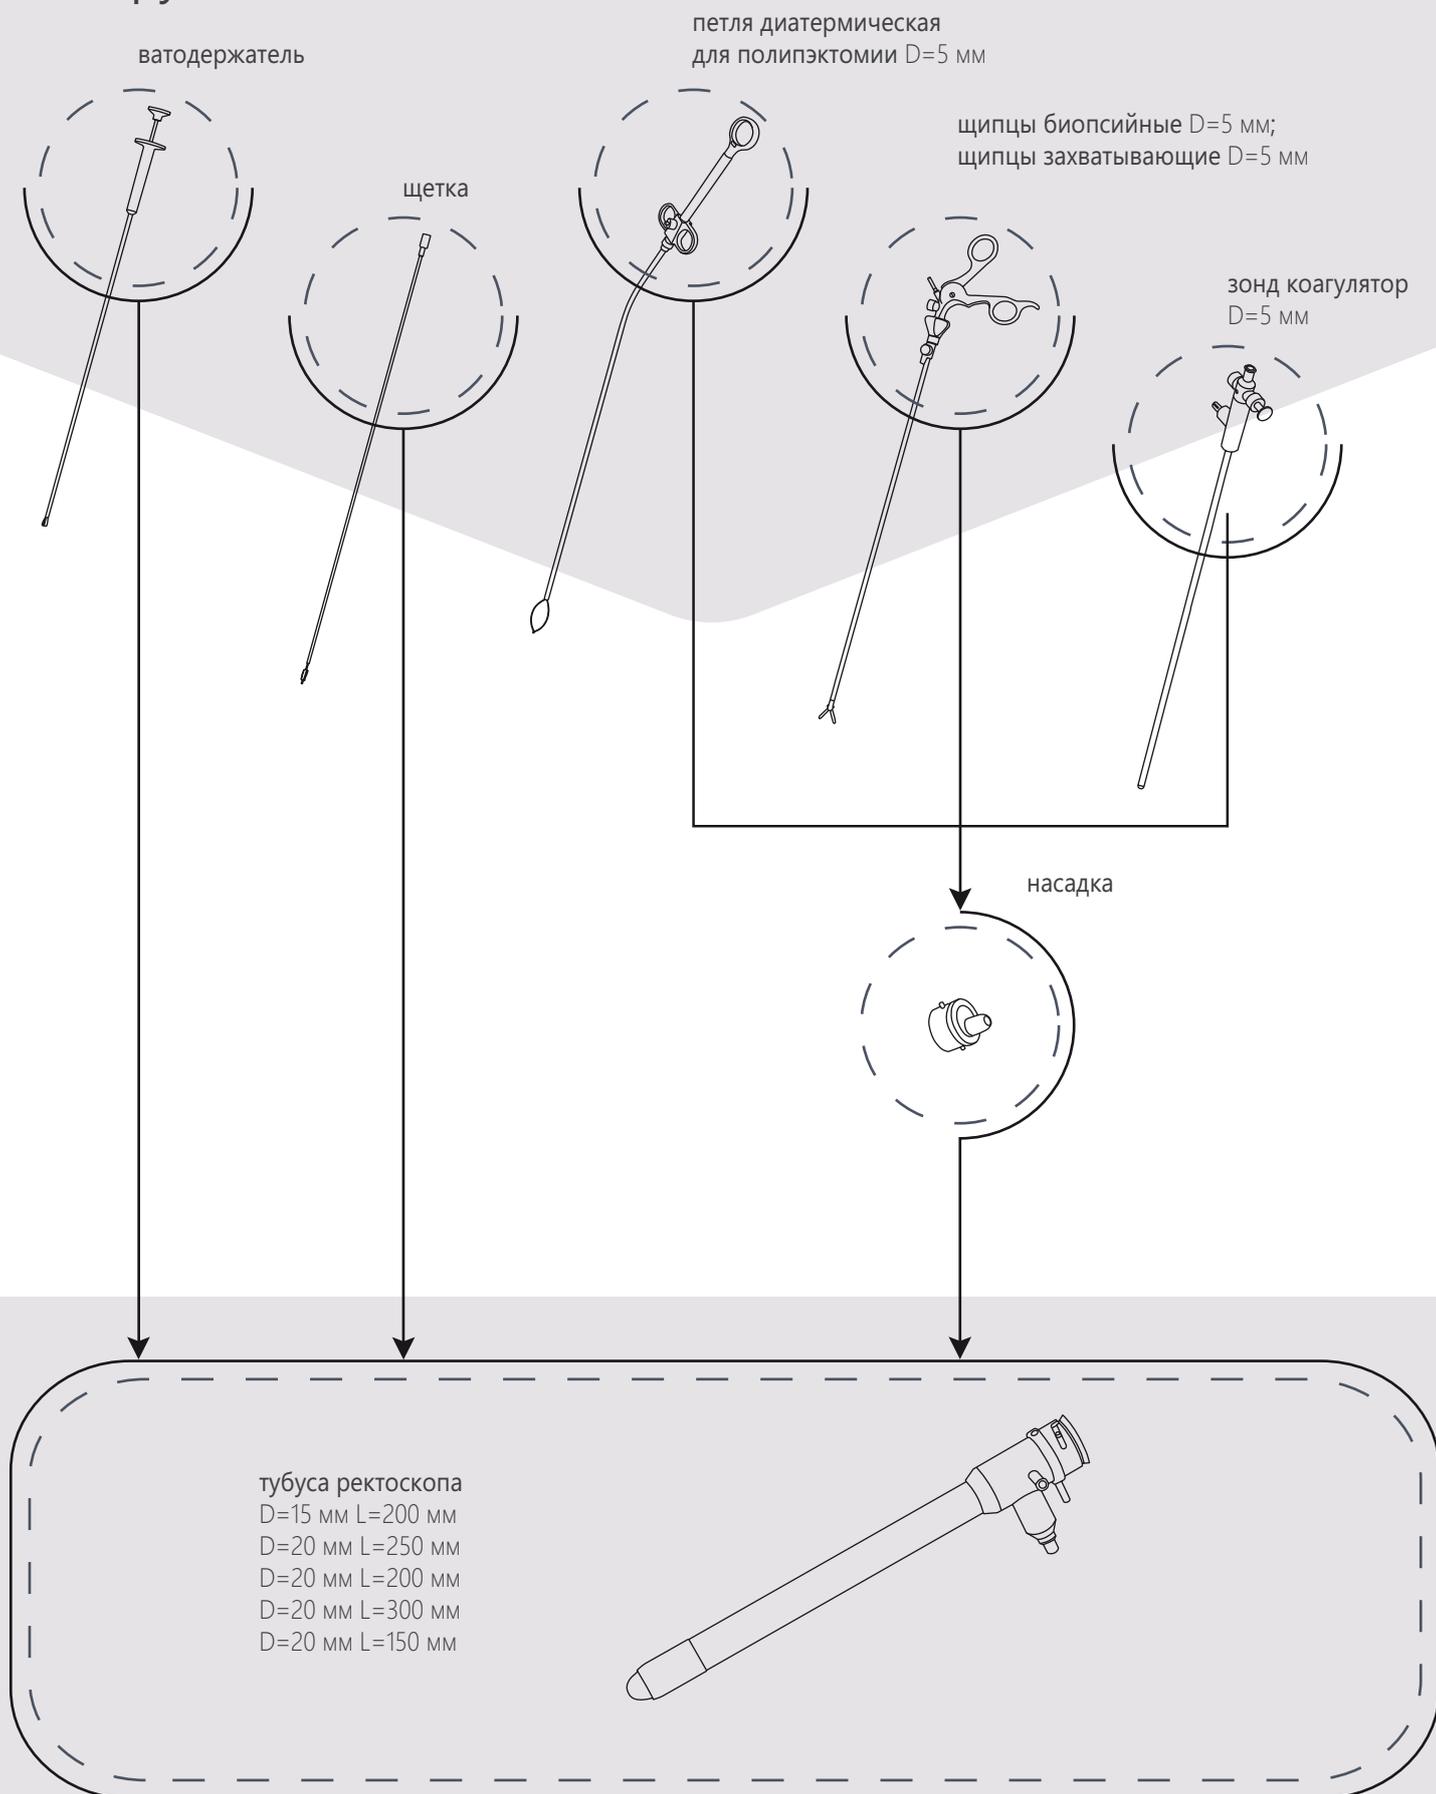



## Аноскопы смотровые и операционные

**Аноскопы «ОПТИМЕД»** - для визуальной диагностики и терапии заболеваний прямой кишки. Аноскопы позволяют провести визуальный осмотр внутренней поверхности прямой кишки, выполнить биопсию, взятие мазков, диагностировать заболевание на ранней стадии и своевременно предпринять терапевтические меры.



### Особенности

- операционные и смотровые аноскопы;
- встроенная волоконная осветительная система;
- атравматичные дистальные концы;
- нержавеющая сталь;
- операционные аноскопы с П-образным вырезом или косым срезом дистального конца;
- смотровой аноскоп с боковым окном.



### Характеристики:

Рабочий диаметр:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - смотровой аноскоп | 20 мм     |
| - операционные      | 20, 24 мм |

Рабочая длина:

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| - смотровой аноскоп | 70 мм |
| - операционные      | 58 мм |

Изготовленные из нержавеющей стали с волоконными оптическими системами аноскопы предназначены для использования с эндоскопическими осветителями «ОПТИМЕД».

Атравматичные дистальные концы обеспечивают безопасное введение аноскопов. Варианты исполнения дистальных концов операционных аноскопов, учитывают различные предпочтения врачей.

Операционные аноскопы оптимизированы для совместного применения с лигаторами для наложения латексных колец на геморроидальные узлы.



## Аноскоп смотровой

- атравматичный закрытый оливообразный дистальный конец;
- нержавеющая сталь, матовая поверхность;
- встроенная осветительная система с волоконным световодом;
- угол направления наблюдения 90 градусов;
- рабочая длина 70 мм.

9.950.642

D=20 мм



## Аноскопы операционные

- атравматичный оливообразный дистальный конец обтуратора;
- нержавеющая сталь, матовая поверхность;
- встроенная осветительная система с волоконным световодом;
- рабочая длина 60 мм.

276.01.00 с П-образным вырезом D=20 мм

276.01.00-01 с П-образным вырезом D=24 мм

276.01.00-02 с косым срезом D=20 мм

276.01.00-03 с косым срезом D=24 мм



## Лигатор механический для латексных колец

- многоразовый;
- нержавеющая сталь, матовая поверхность;
- конусовидный наконечник;
- зажим для механического лигатора - опционально.




## Лигатор вакуумный для латексных колец

- многоразовый;
- нержавеющая сталь, матовая поверхность;
- конусовидный наконечник;
- угол наклона дистального конца рабочей части:
  - 12° вниз
  - 30° вверх
  - 30° вниз



## Совместимость элементов аноскопов

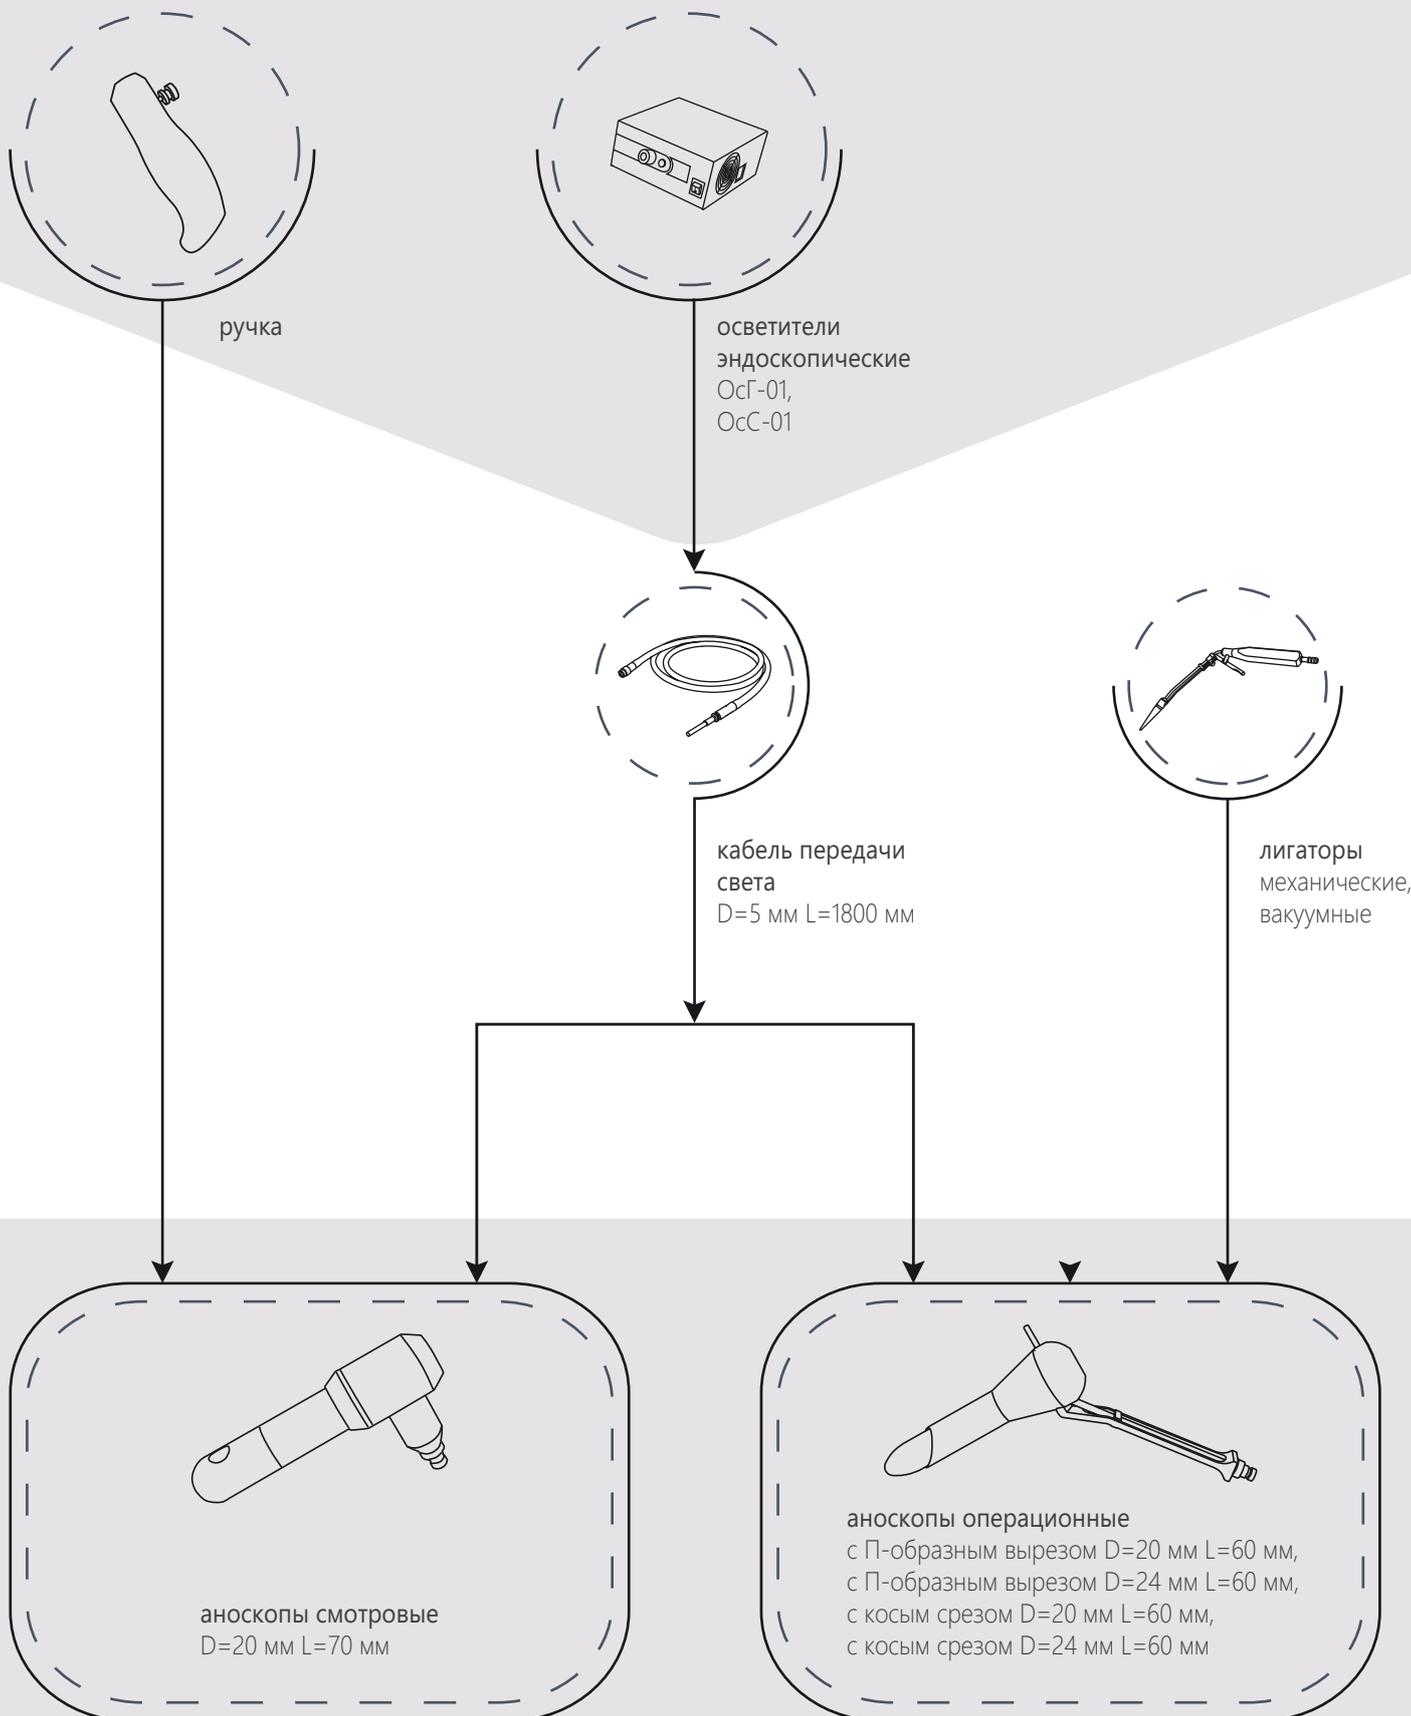



## Осветитель галогеновый ОсГ-01

- экономичная модель компактного осветителя;
- цветовая температура 3400 К;
- освещенность 10 000 лк.



## Осветитель светодиодный ОсС-01

- цветовая температура 4200 К;
- спектр излучения максимально приближен к белому свету;
- освещенность 10 000 лк;
- высокая экономичность, низкое электропотребление;
- регулировка светового потока - опционально.



## Кабели для передачи света волоконно-оптические (световодные)

- для передачи света от эндоскопического осветителя к тубусам и аноскопам;
- автоклавируемые кабели - опционально;
- кабели с коннекторами других типов - опционально.



Код	Световой диаметр	Рабочая длина	Тип коннектора эндоскопа
075-16	5,0 мм	1800 мм	Storz
079-08	5,0 мм	2300 мм	Storz